




## Карта заказа Датчики температуры для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности

### Обозначение при заказе игольчатых датчиков температуры


### Обозначение при заказе игольчатых моделей с выходом «сопротивление»

**ДТСХХ4-Х.ХХ.Х/Х.Х-Х**

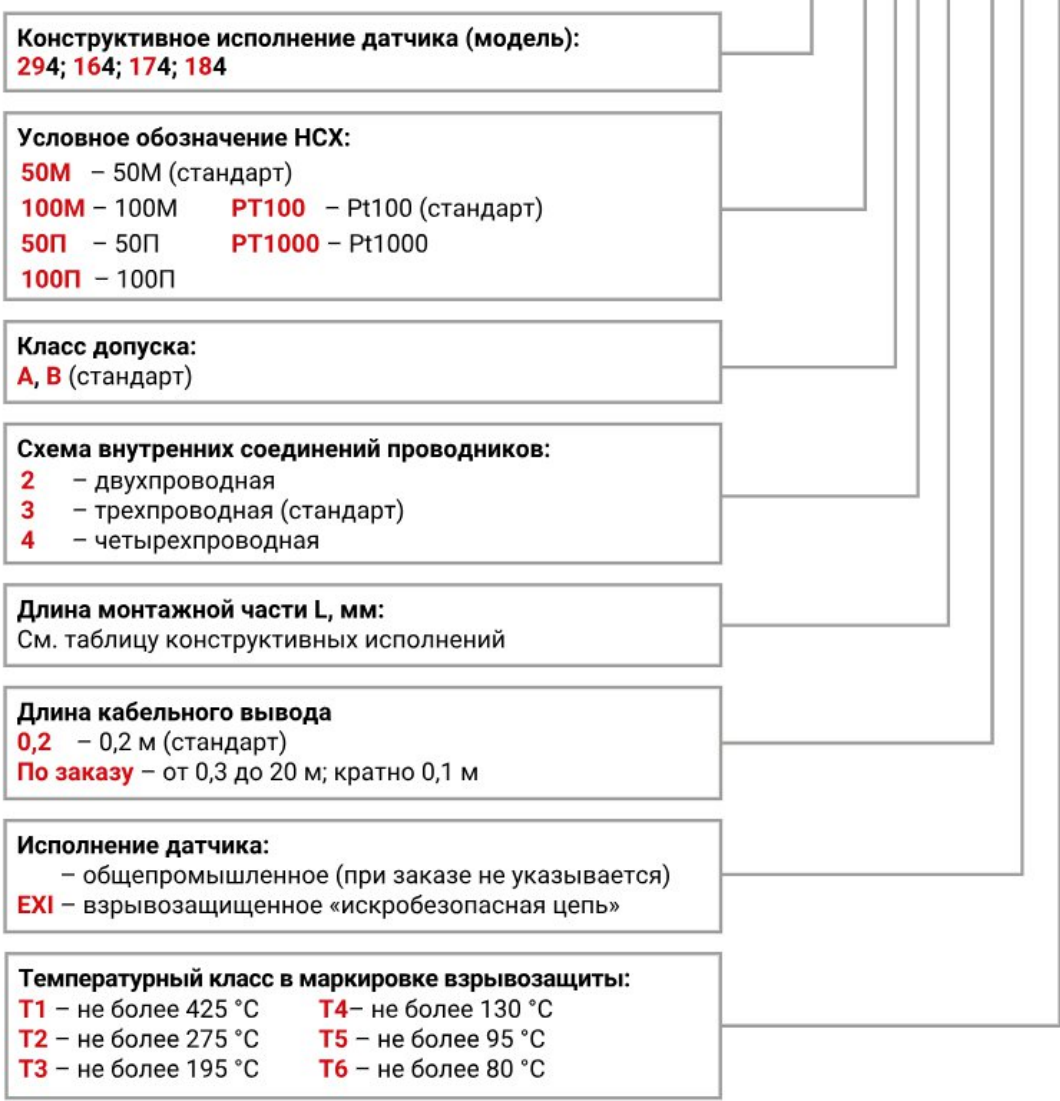

ДТС Х - Х . Х Х . Х / Х Х Х

## Обозначение при заказе игольчатого датчика с выходом «термопара»

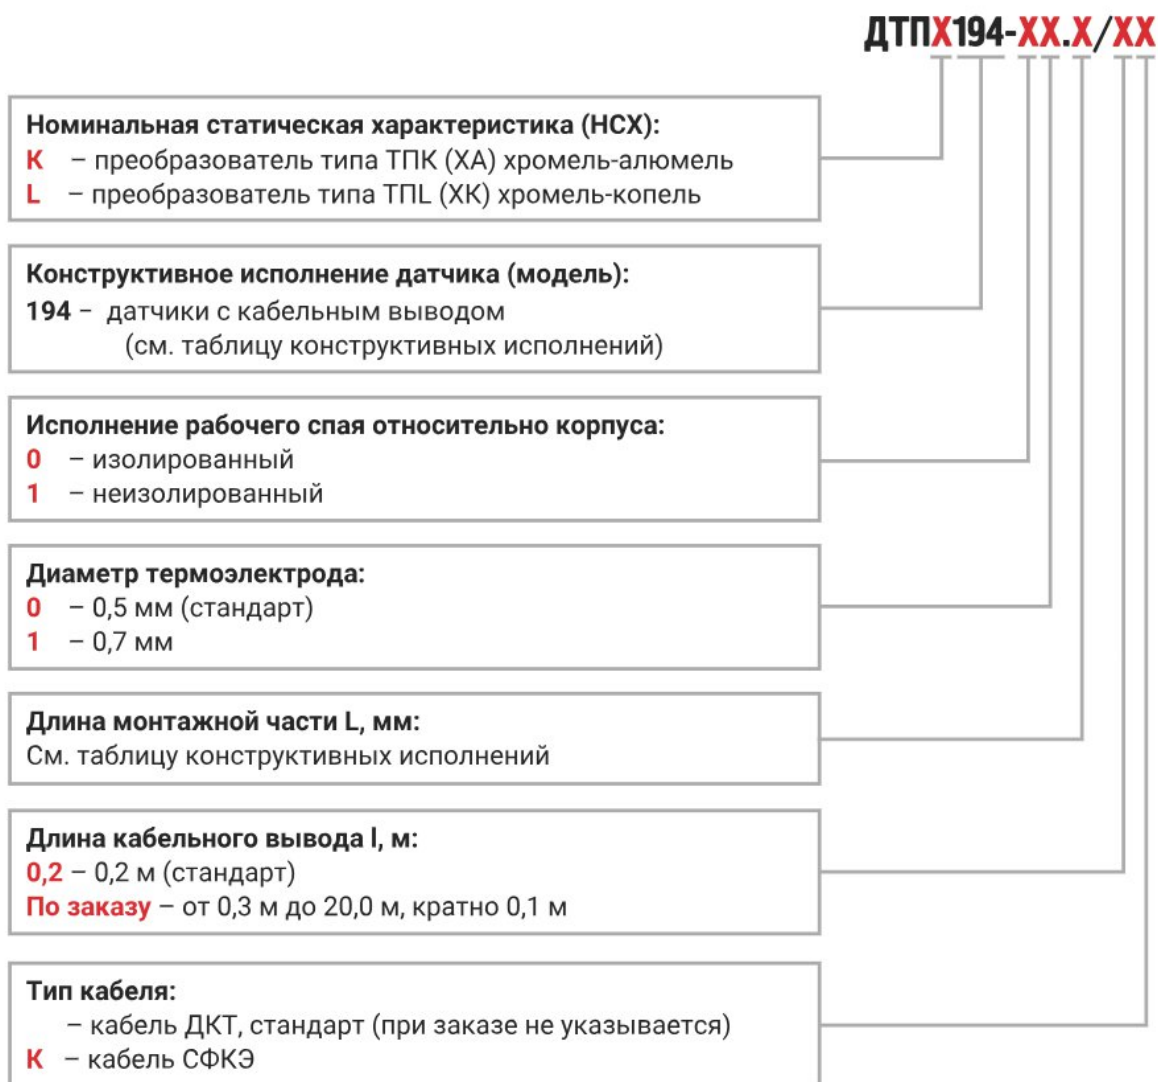

ДТП Х 194- Х Х . Х / Х Х

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48  
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: [zakaz@itrostov.ru](mailto:zakaz@itrostov.ru)

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

## Обозначение при заказе датчиков температуры с CLAMP присоединением

### Обозначение при заказе ДТС205

**ДТС205-Х.АХ.ХСІХ**

Номинальная статическая характеристика (НСХ):

**PT100; PT1000**

Класс допуска:

**A**

Схема соединения:

**3** – трехпроводная

**4** – четырехпроводная

Длина монтажной части, мм:

**40; 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180;**

**200; 220; 240; 260; 280;**

**300; 320; 340; 360; 380;**

**400; 420; 440; 460; 480;**

**500; 520; 540; 560; 580; 600; 630**

Конструктивное исполнение:

**CI** – Clamp


Диаметр Clamp:

**25; 32; 40; 50**

ДТС205- Х .А Х . Х .CL Х

## Обозначение при заказе ДТС305М и ДТС415М

**ДТС****XX**5М-РТ100.**X.X**.МГ.С**IX**.И[**X**]

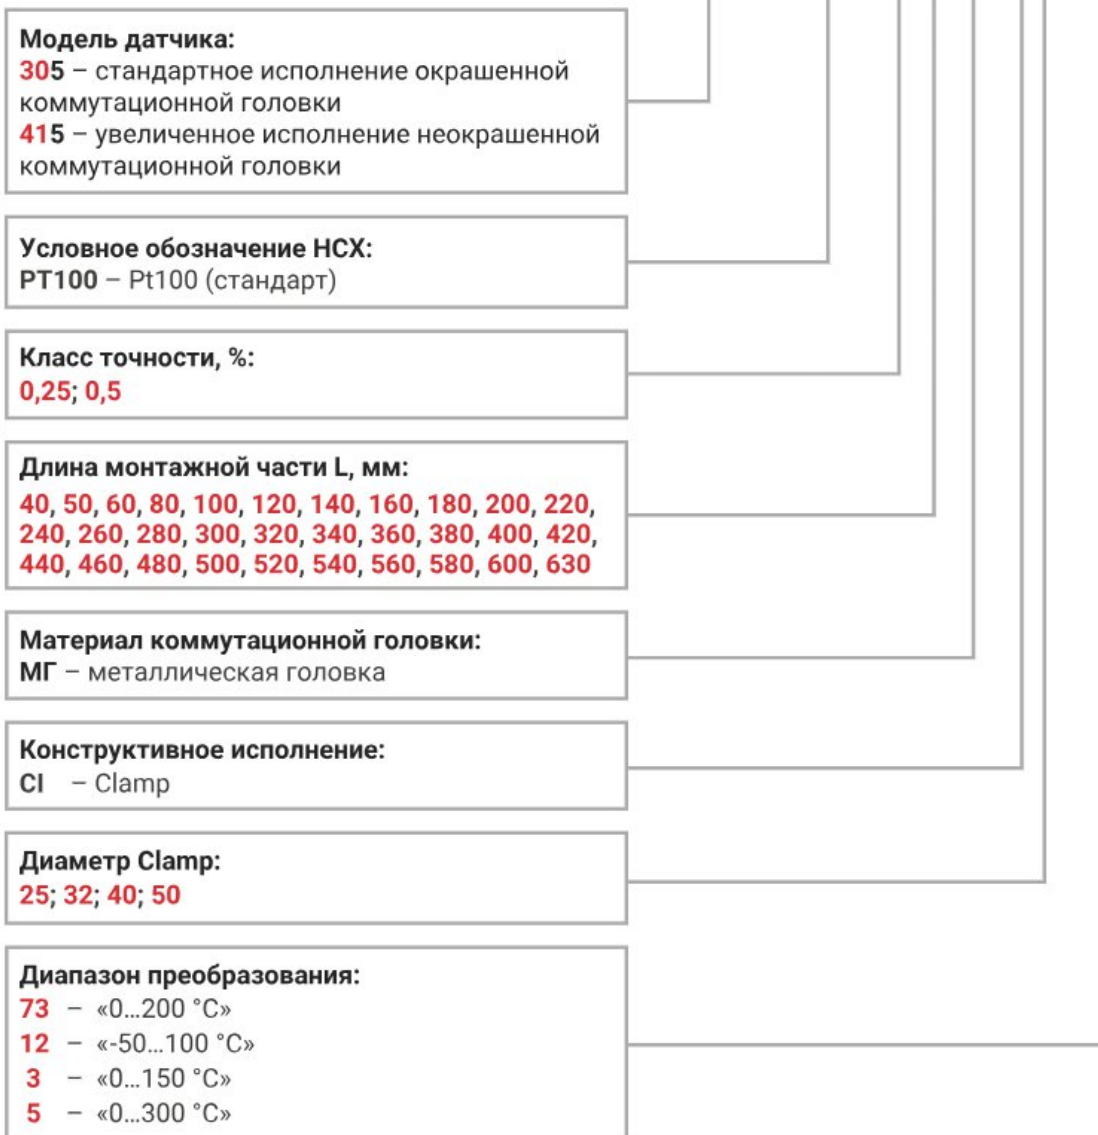

ДТС   X   М-РТ100.   X   .   X   .МГ.С  X   .И [   X   ]